

# DC-8

Ультразвуковая  
диагностическая система



# ВДОХНОВЕНИЕ, ПРЕВОС



Последние десять лет мы непрерывно развивали линейку ультразвуковых сканеров Mindray. Мы внимательно прислушиваемся к клиентам и постоянно стремимся улучшать наши продукты, учитывая Ваши потребности. Представляем новую модель DC-8, которая является олицетворением нашей упорной работы.

# СХОДЯЩЕЕ ОЖИДАНИЯ



Именно Ваши потребности были взяты за основу при разработке функционала и возможностей DC-8. Продвинутое качество изображения и эргономика — это те отличительные особенности, которые позволяют улучшить качество диагностики пациентов. Совмещая все эти характеристики в одном сканере, мы представляем Вам современный инструмент для решения каждодневных задач.

# Испытанные технологии Превосходное качество изображения



Качество изображения стало основой построения нового DC-8. Мы разработали абсолютно новую платформу, которая, благодаря новым технологиям получения изображения и алгоритмам его обработки, способна адаптироваться к специфике каждого пациента. Всё это позволяет легко получать превосходное качество изображений в трудных и тяжелых для исследования случаях.



#### **ЗТ – новая технология производства датчиков**

Уникальная технология Mindray, которая позволяет расширить частотный диапазон и уменьшить потери сигнала при передаче и, как следствие, улучшить соотношение сигнал/шум и разрешающую способность. Теперь вы сможете:

- сканировать на более высокой частоте даже на больших глубинах
- быстрее и легче получать клинически достоверные изображения
- получать больше полезной информации при исследовании трудных пациентов

**HR Flow** инновационная технология, улучшающая в режиме ЦДК визуализацию мельчайших сосудов как по отдельности, так и в комплексе. Благодаря реализованным в ней технологиям наша система способна:



- распознавать и визуализировать самые слабые потоковые сигналы
- обеспечивать высочайшее пространственное разрешение, не теряя при этом в чувствительности и проникающей способности

**Ультра-широкополосная нелинейная обработка сигнала** - новейшая запатентованная технология Mindray, позволяющая улучшить контрастное разрешение. Применяя ультра-широкополосную передачу сигнала, система оперирует гармоническими и нелинейными фундаментальными сигналами, в результате получая:


- соотношение сигнал/шум на 20-30% лучше по сравнению с системами того же класса
- длину получаемого сигнала с повышенным разрешением на 20-30% выше для лучшей визуализации


**Технология iClear высокой четкости:** технология подавления паразитного шума улучшает контрастное разрешение и помогает при визуализации патологий.

**iBeam** – сложносоставное многолучевое сканирование комбинирует несколько изображений, полученных под разными углами. Результирующее изображение имеет более высокое контрастное разрешение и улучшенное качество визуализации.

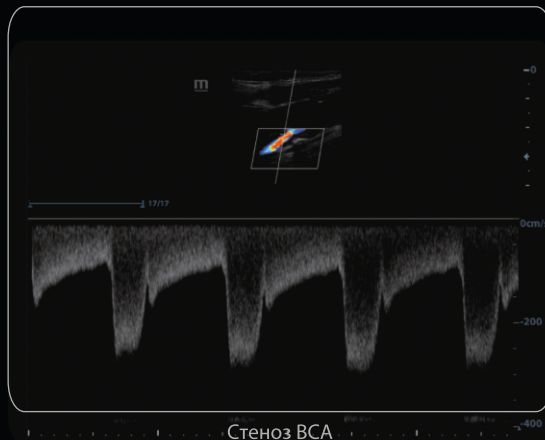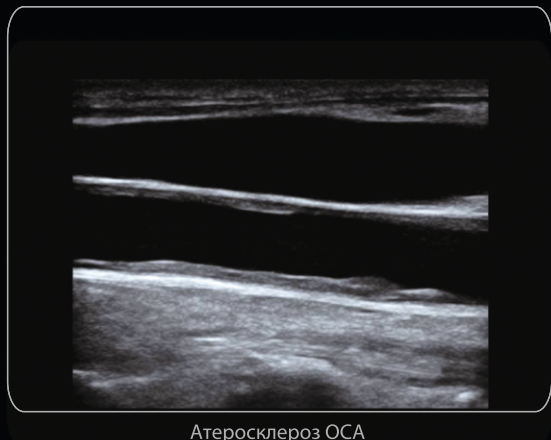


# УВЕРЕННОСТЬ В ДОСТОВЕРНОСТИ

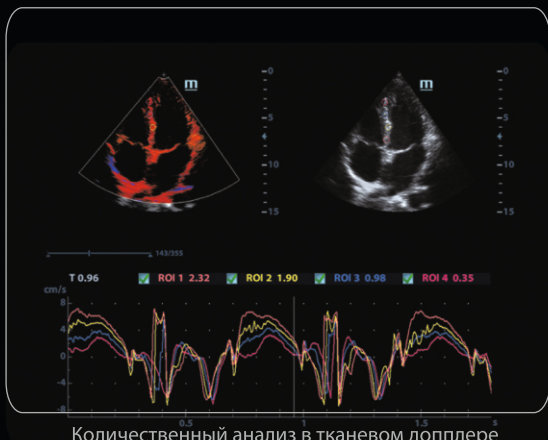

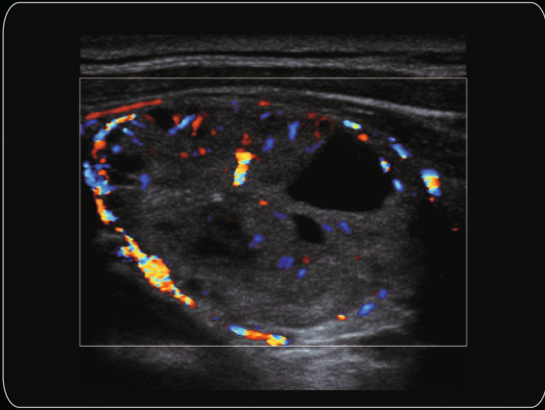

Образование в ЩЖ

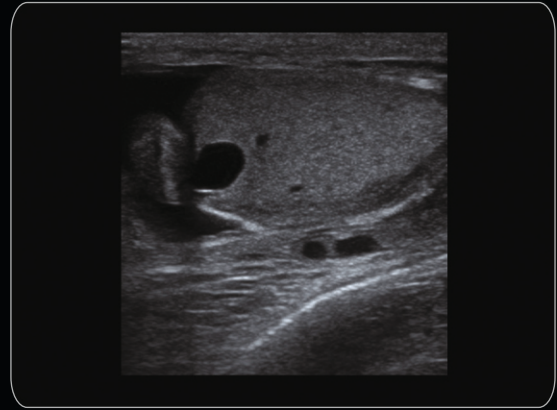


Образование в яичке




Лицо плода (28 недель)



Плод (14 недель)

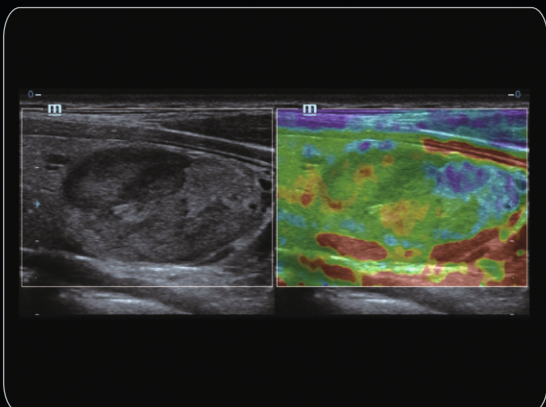

Эластография образования в МЖ

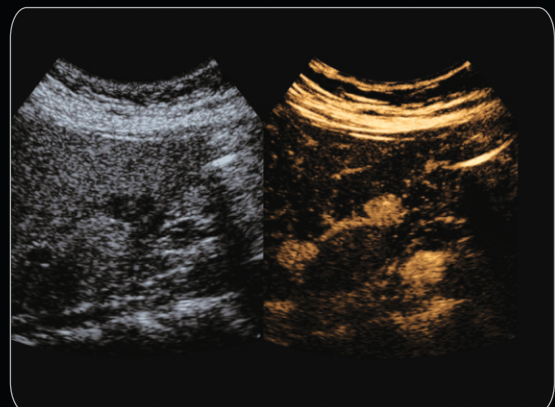

Образование в печени (с контрастированием)

# ПОНИМАНИЕ КАК ТВОРЧЕСТВО



DC-8 предназначен для упрощения Вашего рабочего процесса и уменьшения ежедневного напряжения. Новая платформа предоставляет большую гибкость при пост-обработке полученных данных благодаря технологии «сырых» данных. Данная технология позволяет достичь высокой производительности выполняемых исследований. В любой момент у Вас есть возможность обрабатывать полученные ранее изображения для уточнения или корректировки диагноза.

Технология «сырых» данных – это мощный инструмент, позволяющий изменять:

- усиление, динамический диапазон, карты серого и шумоподавление iClear в B-режиме
- инверсию, карты раскрашивания и сглаживание в ЦДК
- усиление, базовую линию, угол, инверсию, пристеночный фильтр и скорость прокрутки в режиме спектрального доплера
- проводить любые измерения и редактировать комментарии

DC-8 даже может осмелиться подсказать Вам следующий шаг.

Интеллектуальная автоматизированная система ведения протокола исследования автоматически вставляет комментарии, вызывает необходимые измерения и даже больше. Всё это возможно благодаря модулю **iWorks**, в котором уже заложены стандартные протоколы проведения исследования. Кроме того, всегда существует возможность добавления и редактирования своих собственных протоколов.

iWorks позволяет больше сконцентрироваться на пациенте, не отвлекаясь на лишние действия и нажатия клавиш:

- автоматическое выставление параметров изменения изображения и режимов работы сканера
- автоматическая вставка комментариев
- автоматический вызов требуемых исследований
- создание собственных протоколов для нестандартных случаев



# КОМФОРТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ



В нашей системе DC-8 мы постарались внедрить все возможные решения, чтобы сделать Вашу работу на сканере комфортной каждый день. Новая форма панели и по-новому организованные органы управления делают DC-8 по-настоящему универсальным инструментом.

LCD монитор высокой четкости передает мельчайшие подробности, а режим полноэкранного изображения iZoom облегчает оценку мелких структур. Полностью настраиваемый сенсорный командный экран значительно снижает время, затрачиваемое на поиск нужного инструмента – у Вас всегда всё под рукой.



#### **19ти дюймовый монитор высокой четкости**

- более крупная исследуемая область снижает нагрузку на глаз
- широкие углы обзора позволяют удобно расположиться на рабочем месте

#### **Поворотная консоль монитора**

- легкое перемещение в любом направлении
- удобная складывающаяся конструкция

#### **10,4 дюймовый сенсорный командный экран**

- прямой доступ ко всем функциям и настройкам

#### **Лёгкая в использовании панель**

- настраиваемое положение и высота панели
- сгруппированные по функционалу органы управления
- специально разработанная «в форме почки» панель
- подогреваемый держатель для геля
- специализированный держатель внутривидеодатчика



Работайте с лучшими,  
всё остальное компромисс!

---

**8 (800) 775-10-98**

**medliga.ru**